北京天净沙基因科技有限公司

产品质量检验报告

Certificate of Analysis

产品名称 Product

17-76500　淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒探针法 qRT-PCR 试剂盒（含内参）

产品编号: 17-76500　　引物探针（含内参）干粉编号：yp17-76500
阳性对照编号：pc76500-NC_004291

生产日期 Mfg.date

2025-08-01

生产批号 Lot No.

030060lyy

检测日期 Test.date

2025-08-01

保质期 Shelf life.

12 个月

项目标准 Parameter	标准 Specification	检测结果 Result
分析灵敏度 Analytical Sensitivity	用阳性对照测试不低于 100 拷贝/反应	合格
分析特异性 Analytical Specificity	1、 不能扩增其他病毒 DNA。 2、 In-Silico PCR 分析 Genbank，引物和探针（含内参）不跟其他核酸发生交叉反应。	合格
线性范围 Linearity Range	1E6-1E1 标准曲线的 r2 不小于 0.95	合格

结论 Conclusion：

合格 Conforming


备注 Remarks：

Lyy 生产


编制 Issued by：　　审核 Reviewed：DX

地址：北京市海淀区上地信息路 1 号 1 号楼 4 层 404

附件：质检原始数据

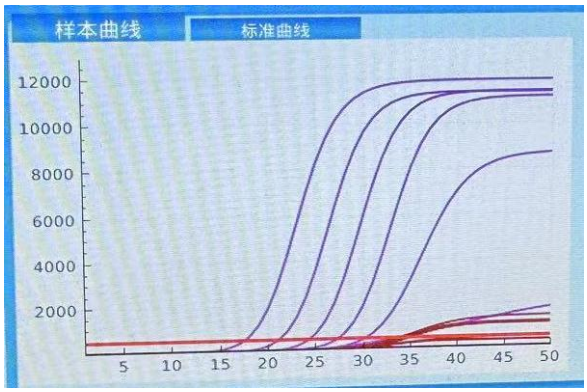

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	NC
FAM 通道	33.88	30.43	27.6	24.61	21.39	17.84	-
Cy5 通道	33.9	33.6	32.15	32.68	31.45	31.41	-

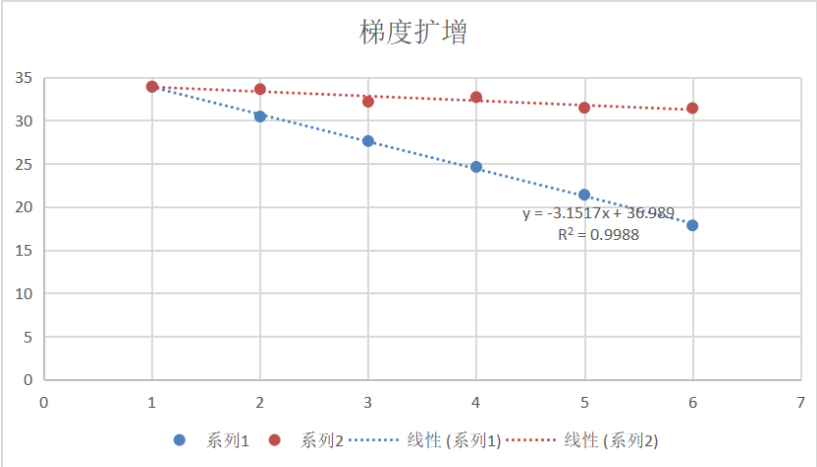

质检设备：实时荧光定量 PCR 仪
产品型号：AGS8830-16
设备厂家：杭州安誉科技